



Hospital Municipal de Major Vieira

Diretor Técnico Dr Juliano Brasil – CREMESC 12860

CNPJ, 79 376.760/0001-58

Praça Ercília Gadotti, n° 1333, Major Vieira/SC – Telefone (47) 36551113

Major Vieira, 04 de julho de 2022

**Ao Setor de Licitações
Prefeitura Municipal
Major Vieira – SC**

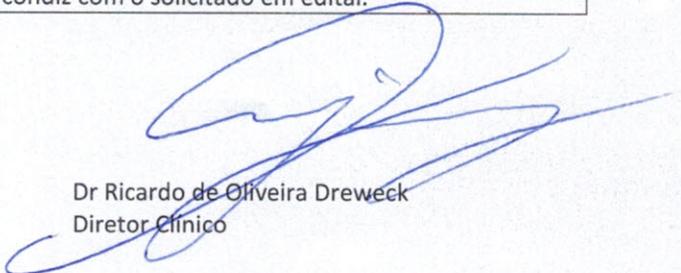
Prezados,

Conforme necessidade de parecer técnico para o Processo Licitatório referente a aquisição do aparelho de anestesia, seguem abaixo relatório de avaliação das propostas analisadas:

N	EMPRESA	PARECER
01	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	Empresa não especifica número de registro na ANVISA; Monitor Multiparamétrico sem especificações para realizar a avaliação técnica; Trigger ou sensibilidade ao fluxo 0,5 lt (não condiz com edital); Não cotou analisador de gases;
02	COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Não cotou monitor Multiparamétrico; Não cotou analisador de gases; Não possui curva de espirometria;
03	MEDICALWAY	Não especifica Trigger ou sensibilidade ao fluxo; Manual da ANVISA diz que a partir de 0,5 lt (não condiz com edital); Como já temos um equipamento dessa marca, vivemos a dificuldade para encontrar peça para troca, exemplo célula de oxigênio.
04	FLORESTAMED COMERCIO	Proposta copiada do Edital; Não cotou monitor; Não tem especificações; Não cotou analisador de gases; Não possui loop de espirometria; Equipamento só possui uma gaveta pelo manual da ANVISA;
05	MCA LTDA	Descreveu Trigger ou sensibilidade ao fluxo 1,0 lt (não condiz com edital) Não possui loop de espirometria;
06	MA HOSPITALAR	Descritivo condiz com o solicitado em edital.

Atenciosamente,

Joci Mari de Oliveira da Silveira
Superintendente


Dr Ricardo de Oliveira Dreweck
Diretor Clínico

HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA